






ПРАЙС-ЛИСТ на 01.01.2023 г.



№	Наименование	Определяемые компоненты	Количество полосок в упаковке	Цена за упаковку, руб., без НДС	Срок годности, месяц	Кол-во упаковок в коробке
0005	<p>«УРИПОЛИАН-10М»</p> <p>Аналог тест-полосок: (URS 10, UrineRS A10, "Dirui A10 (Uristik A10), Multichек 10LG, Multistix 10SG (старого образца) и другим полоскам)</p> 	<p>Глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь, билирубин, уробилиноген, нитриты, плотность, лейкоциты, белок и pH</p>	100	по запросу	24	30
0006	<p>«УРИПОЛИАН-10Н»</p> <p>Аналог тест-полосок: (Dirui 10H и другим полоскам)</p> 	<p>Глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь, билирубин, уробилиноген, нитриты, плотность, лейкоциты, белок и pH</p>	100	по запросу	24	30
0016	<p>«УРИПОЛИАН-10G»</p> <p>Аналог тест-полосок: (UrineRS H10 и другим полоскам)</p> 	<p>Глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь, билирубин, уробилиноген, нитриты, плотность, лейкоциты, белок и pH</p>	100	по запросу	24	30
0004	<p>«УРИПОЛИАН-11У»</p> <p>Аналог тест-полосок: (Uriscan 11 strip, Урискан-11 (ГЕН 11), Урискан URISCAN GEN 11 и другим полоскам)</p> 	<p>Глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь, билирубин, уробилиноген, нитриты, плотность, лейкоциты, белок и pH</p>	100	по запросу	24	30

По запросу «Уриполиан-11У, 10Н, 10М» № 25 в количестве 1 пенала будет вкладываться в очередной заказ или же, образцы можно будет получить самовывозом!

Отечественный АНАЛИЗАТОР МОЧИ "Биос-А" на 10-11 параметров, сделано в России

0001		Глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь, билирубин, уробилиноген, нитриты, плотность, лейкоциты, белок, рН, аскорбиновая кислота	по запросу
------	---	---	-------------------


Тест-Полоски индикаторные для Анализаторов Мочи: "Биос-А" и АМ-2100, наши цены Вас очень приятно удивят (запрос цены: info@biosensoran.ru)

0007	<p><u>«УРИПОЛИАН-11U»</u></p> 	Глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь, билирубин, уробилиноген, нитриты, плотность, лейкоциты, белок, рН, аскорбиновая кислота	100	по запросу	24	30
0008	<p><u>«УРИПОЛИАН-10U»</u></p> 	Глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь, билирубин, уробилиноген, нитриты, плотность, аскорбиновая кислота, лейкоциты, белок и рН	100	по запросу	24	30

Тест-Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения АЛКОГОЛЯ В КРОВИ по слюне.

0014	<p><u>«Алкосенсор»</u></p> 	Алкоголь (0,0-2,0 промилле) чувствительность 0,1-0,3 Скидки не предоставляются!	1	по запросу	12	100
0015			25	по запросу		60
0016	<p><u>«Алкосенсор-М»</u></p> 	Алкоголь (0,0-1,0 промилле) чувствительность 0,1-0,2 Скидки не предоставляются!	1	по запросу	12	60
0017			25	по запросу		

Тест-Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения глюкозы (сахара) в крови.

0018	 <p>«Диаглюк»</p>	Глюкоза (0,0-55,5 ммоль/л) Чувствительность 1,1 ммоль/л	50	по запросу	18	60
0019			100	по запросу		

Тест-Полоски индикаторные для определения pH влагалищной жидкости







0020	 <p>«Кольпо-тест pH»</p>	Кислотность (3,0-7,0 ед.) Чувствительность 3,0 ед.	1	по запросу	24	72	
0022			5	по запросу	24	72	
0023			25	по запросу	24	60	
0024							50
0025							100






Запрос цен на "Кольпо-тест pH" № 25, 50, 100: ООО "Экс Экво", Тел.: +7 (499) 747-94-24; +7 (915) 295-21-60, e-mail: exaequo@gmail.com, web: www.kolpotest.ru






Тест-Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения в моче:

наши цены Вас очень приятно удивят (запрос цены: info@biosensoran.ru)

№	Наименование	Определяемые компоненты	Количество полосок в упаковке	Цена за упаковку, руб., без НДС	Срок годности, месяц	Кол-во упаковок в коробке
0027	 <p>«Уриглюк-1»</p>	Глюкоза (0,0-112,0 ммоль/л) чувствительность 0,6-0,9 ммоль/л	50	по запросу	24	60
0028			100	по запросу		
0029			150	по запросу		
0030	 <p>«Урикет-1»</p>	Кетоновые тела (0,0-16,0 ммоль/л) чувствительность 0,5 ммоль/л	50	по запросу	24	60
0031			100	по запросу		
0032			150	по запросу		
0033	 <p>«Урибел»</p>	Белок (0,0-10,0 г/л) чувствительность 0,1 г/л	50	по запросу	24	60



0034			100	по запросу		
0035			150	по запросу		
0036	<p>«Ури-рН»</p> 	<p>рН (5,0-9,0 рН) (5,0;6,0;6,5;7,0;7,5;8,0;9,0)</p>	50	по запросу	24	60
0037			100	по запросу		
0038			150	по запросу		
0039	<p>«Уриполиан-1he»</p>  <p>(Уриполиан-ХN")</p>	<p>Гемоглобин и эритроциты (скрытая кровь) (0,0-250,0 эри/мкл) чувствительность 10 эри/мкл</p>	50	по запросу	24	60
0040			100	по запросу		
0041	<p>«Кетоглюк-1»</p> 	<p>Глюкоза, кетоновые тела</p>	50	по запросу	24	60
0042			100	по запросу		
0043	<p>«Уриполиан-2А»</p>  <p>(Уриполиан-ХN)</p>	<p>Белок, рН</p>	50	по запросу	24	60
0044			100	по запросу		
0045	<p>«Уриполиан-2В»</p>  <p>(Уриполиан-ХN)</p>	<p>Билирубин, уробилиноген</p>	50	по запросу	24	60
0046			100	по запросу		





0047	«Уриполиан-2С» 	Глюкоза, белок	50	по запросу	24	60
0048	(Уриполиан-ХН)		100	по запросу		
0049	«Уриполиан-3А» 	Глюкоза, белок и рН	50	по запросу	24	60
0050	(Уриполиан-ХН) ТРОЙНОЙ ТЕСТ		100	по запросу		
0051	«Уриполиан-4А» 	Глюкоза, кетоновые тела, белок и рН	50	по запросу	24	30
0052	(Уриполиан-ХН)		100	по запросу		
0053	«Уриполиан-5А» 	Глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь, белок и рН	50	по запросу	24	30
0054	(Уриполиан-ХН)		100	по запросу		
0055	«Уриполиан-5В» 	Скрытая кровь, белок, нитриты, лейкоциты и рН	50	по запросу	24	30
0056	(Уриполиан-ХН)		100	по запросу		

0057	«Уриполиан-6А» 	Глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь, уробилиноген, белок и рН	50	по запросу	24	30
0058	(Уриполиан-ХН)		100	по запросу		
0059	«Уриполиан-7А» 	Глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь, билирубин, уробилиноген, белок и рН	50	по запросу	24	30
0060	(Уриполиан-ХН)		100	по запросу		
0061	«Уриполиан-8А» 	Глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь, билирубин, уробилиноген, лейкоциты, белок и рН	50	по запросу	24	30
0062	(Уриполиан-ХН)		100	по запросу		
0063	«Уриполиан-9А» 	Глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь, билирубин, уробилиноген, нитриты, плотность, белок и рН	50	по запросу	24	30
0064	(Уриполиан-ХН)		100	по запросу		
0065	«Уриполиан-10А» 	Глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь, билирубин, уробилиноген, нитриты, плотность, аскорбиновая кислота, белок и рН	50	по запросу	24	30
0066	(Уриполиан-ХН)		100	по запросу		







0067	«Уриполиан-10В» 	Глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь, билирубин, уробилиноген, нитриты, плотность, лейкоциты, белок и рН	50	по запросу	24	30
0068	(Уриполиан-ХН)		100	по запросу		
0069	«Уриполиан-11А» 	Глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь, билирубин, уробилиноген, нитриты, плотность, лейкоциты, аскорбиновая кислота, белок и рН	25	по запросу	24	30
0070	(Уриполиан-ХН)		50	по запросу		
0071	(Уриполиан-ХН)		100	по запросу		


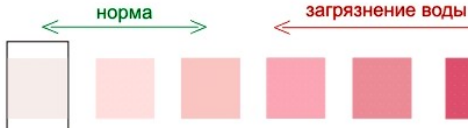



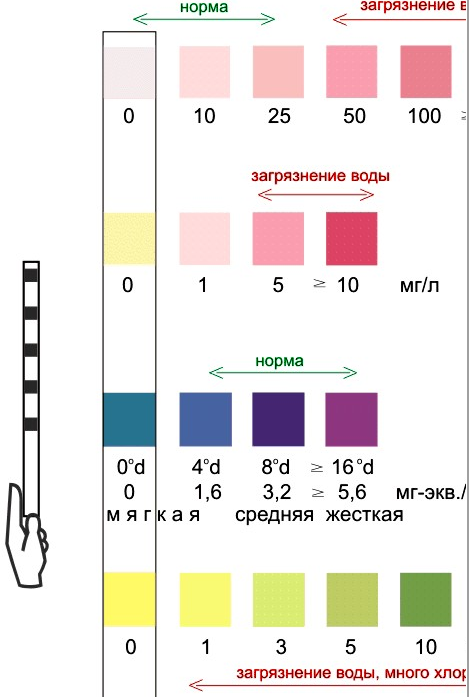
Тест-Полоски индикаторные на подлинность мочи, для определения: рН, креатинина, относительной плотности, нитритов, глутаральдегида и пиридиниум хлорохромата(ПХХ) в моче. (без скидок)

0072	«Уриреал-1сн» 	Креатинин	1	по запросу	24	30
0074	(Уриреал-ХН)		50	по запросу		
0075	(без скидок) (Уриреал-ХН)		100	по запросу		
0076	«Уриреал-1рН» 	рН	1	по запросу	24	30
0078	(Уриреал-ХН)		50	по запросу		
0079	(без скидок) (Уриреал-ХН)		100	по запросу		


0080	<p>«Уриреал-1sg»</p>  <p>(без скидок) (Уриреал-ХН)</p>	Плотность	1	по запросу	24	30
0082			50	по запросу		
0083			100	по запросу		
0084	<p>«Уриреал-1ni»</p>  <p>(без скидок) (Уриреал-ХН)</p>	Нитриты	1	по запросу	24	30
0086			50	по запросу		
0087			100	по запросу		
0088	<p>«Уриреал-3А»</p>  <p>(без скидок) (Уриреал-ХН)</p>	Креатинин, рН, плотность	1	по запросу в ООО "Фактор Мед"	24	30
0089			25			
0090			50			
0091			100			
0092	<p>«Уриреал-6А»</p>  <p>(без скидок) (Уриреал-ХН)</p>	Креатинин, рН, плотность, глутаральдегид, пирридиниум хлорохромат	1	по запросу в ООО "Фактор Мед"	24	30
0093			25			
0094			50			
0095			100			

Тест-полоски для анализа воды

№ кат.	Наименование тест-полосок на воду	Определяемые параметры воды	Кол-во тест-полосок в упаковке, (шт.)	Цена без НДС, руб.	Кол-во упаковок в коробке, (шт.)	НДС, %
3001	«Биосенсор-Аква-ГН» Срок годности - 2 года 	<u>Жесткость воды</u> Суммарная молярная концентрация эквивалентов кальция и магния в питьевых, природных, аквариумных и сточных водах, а так же для контроля воды в тепловых сетях (котельных и т.п.). Данный тест полностью готов к работе, не требует использования дополнительных реактивов и оборудования. 	1	по запросу	52	18
3002			3	по запросу	72	
3003			25	по запросу	60	
3004			50	по запросу	60	
3005			100	по запросу	60	
3006	«Биосенсор-Аква-рН» Срок годности - 2 года 	<u>рН (кислотность воды)</u> Определение кислотности (рН) в питьевых, природных (водоемы), аквариумных и сточных водах. Данный тест полностью готов к работе, не требует использования дополнительных реактивов и оборудования. 	1	по запросу	52	18
3007			3	по запросу	72	
3008			25	по запросу	60	
3009			50	по запросу	60	
3010			100	150	60	
3011	«Биосенсор-Аква-Хлор» Срок годности - 2 года 	<u>Активный хлор в воде</u> Для определения хлора в питьевых, природных (водоемы), аквариумных и сточных водах. Данный тест полностью готов к работе, не требует использования дополнительных реактивов и оборудования. 	1	по запросу	52	18
3012			3	по запросу	72	
3014			25	по запросу	60	
3015			50	по запросу	60	
3016			100	по запросу	60	
3017	«Биосенсор-Аква-Нитрат»	<u>Нитраты в воде</u> Определения нитратов в питьевых,	1	по запросу	52	18

3018	<p>Срок годности - 2 года</p> 	<p>природных (водоемы), аквариумных и сточных водах.</p> <p>Данный тест полностью готов к работе, не требует использования дополнительных реактивов и оборудования.</p> 	3	по запросу	72	
3019			25	по запросу	60	
3020			50	по запросу	60	
3021			100	по запросу	60	
3022	<p>«Биосенсор-Аква-Нитрит»</p> <p>Срок годности 2 года</p> 	<p><u>Нитриты в воде</u></p> <p>Определение нитритов в питьевых, природных (водоемы), аквариумных и сточных водах.</p> <p>Данный тест полностью готов к работе, не требует использования дополнительных реактивов и оборудования.</p> 	1	по запросу	52	18
3023			3	по запросу	72	
3024			25	по запросу	60	
3025			50	по запросу	60	
3026			100	по запросу	60	
3027	<p>«Биосенсор-Аква-5»</p> <p>Срок годности 2 года</p> 	<p><u>Жесткость, pH (кислотность), нитриты, нитраты и активный хлор в воде</u></p> <p>Определение: кислотности (pH), жесткости, хлора, нитратов и нитритов в воде, природных (водоемы), аквариумных и сточных водах, а так же для контроля воды в тепловых сетях (котельных и т.п.).</p> <p>Данный тест полностью готов к работе, не требует использования дополнительных реактивов и оборудования.</p> 	1	по запросу	52	
3028			3	по запросу	72	
3029			25	по запросу	30	
3030			50	по запросу	30	
3031			100	по запросу	30	18

3032	<p>«Биосенсор-Аква-6» Срок годности 2 года</p> 	<p>Жесткость, рН (кислотность), нитриты, нитраты, активный хлор, общее растворенное железо в воде</p> <p>Определение: кислотности (рН), жесткости, хлора, нитратов, нитритов, общего растворенного железа в воде, природных (водоемы), аквариумных и сточных водах, а так же для контроля воды в тепловых сетях (котельных и т.п.).</p> <p>Данный тест полностью готов к работе, не требует использования дополнительных реактивов и оборудования.</p>	1	по запросу	52	18
3033			3	по запросу	72	
3034			25	по запросу	30	
3035			50	по запросу	30	
3036			100	по запросу	30	

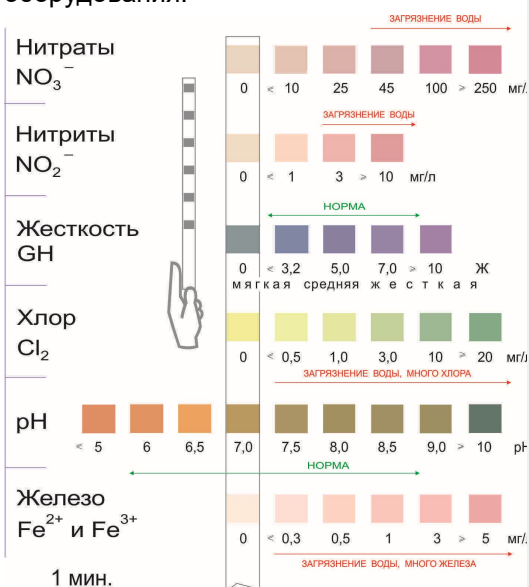

Минимальный заказ на тест-полоски для анализа воды при заказе только данных тест-полосок - от 1 000 руб.

Внимание: Компания ООО «Биосенсор АН» работает по упрощенной системе налогообложения. НДС не выставляется, счет-фактура не выписывается. НДС 10%. Приказ №БГ-3-03/447 от 20.12.2000 г. МРФ по налогам и сборам.

Полный прайс-лист Вы можете получить по запросу цены:
info@biosensor.su